


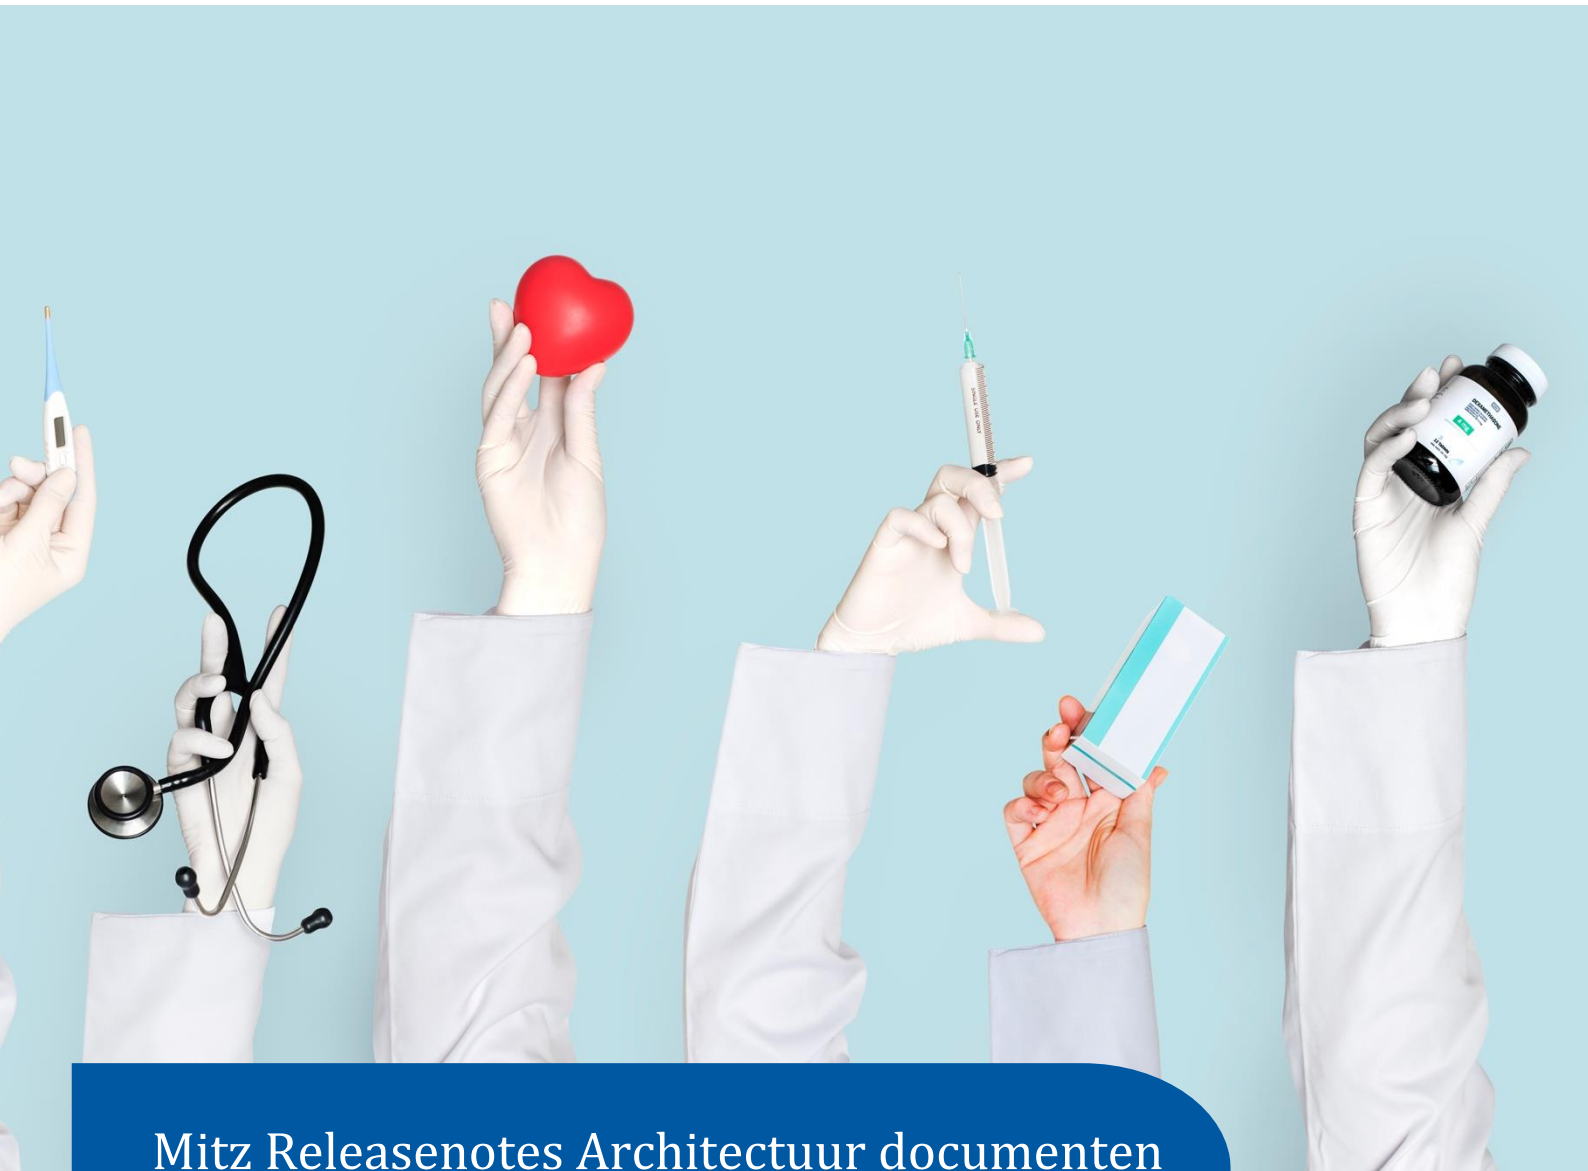

Mitz Releasenotes Architectuur documenten

Status:	Definitief
Versie:	3.8.1.ad1
Datum:	2 juni 2023
Classificatie:	Openbaar

1 Inleiding

1.1 Doel en scope documentatie Mitz architectuur versie 3.8.1

Dit document beschrijft de veranderingen in de documentatie van de Mitz architectuur v3.8.1 (ten opzichte van v3.8.0). Op hoofdlijnen is in de 3.8.1 de ToestemmingsCatalogus geactualiseerd, zodat het dekkend is voor de elektronische uitwisselingen die (op afzienbare termijn) operationeel zijn. Daarnaast zijn er een aantal technische aanpassingen gedaan in de implementatie handleidingen, ten behoeve van de golive. De Mitz 3.8.1 is de eerste versie die daadwerkelijk in productie zal gaan. Op 5 juni 2023 is MijnMitz live gegaan met versie 3.8.1 ad1. Zorgaanbieders die Mitz gebruiken voor het beheer van toestemmingskeuzes informeren hun patiënten/cliënten hierover. Die kunnen dan naar Mitz om hun keuzes vast te leggen.

Doel van de releasenotes is het snel kunnen bepalen welke wijzigingen ten opzichte van een vorige versie zijn doorgevoerd, zodat de impactbepaling van de nieuwe versie op de systemen beperkt kan blijven tot de gewijzigde specificaties. Om in één keer de impact van een nieuwe release te kunnen bepalen, zijn er voor leveranciers die gewerkt hebben met voorgaande versies documenten beschikbaar met track-changes die alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zichtbaar maken.

De architectuur releases voor review en ontwikkeling-test-acceptatie-productie worden aangegeven met 3 cijfers. Een 4-cijferige versie is voor het architectuur intern. De status van een documentatieversie is, conform wat binnen VZVZ gebruikelijk is, als volgt:

- Ter verbetering: ten bate van interne review
- Ter goedkeuring: ten bate van finale check programmteam
- Definitief: ten bate van externe impact bepaling

1.2 Doelgroep voor dit document

Doelgroep van dit document is iedereen die gebruik maakt van de architectuurdokumentatie ten behoeve van de implementatie of gebruik van Mitz-diensten. Daarbij geldt dat het op internet beschikbare afsprakenstelsel voor iedereen het uitgangspunt vormt en de PvE's en IH's vooral voor leveranciers van belang zijn.

Leveranciers die de koppelvlakken tussen Mitz en de systemen van een zorgaanbieder bouwen, realiseren een zogenaamde 'Mitz Connector' (MC). Voor hen is het zelfstandig leesbare PvE AMC (Aansluiting Mitz Connector) bedoeld, met de Implementatie Handleidingen (IH). Het MC kan een onderdeel zijn van een uitwisselingssysteem (US), maar dat hoeft niet. Het PvE AMC vervangt daarmee het PvE AUS. Het PvE AUS is in de release 3.8.1 ad1 nog wel aanwezig, maar zal daarna worden uitgefaseerd. US-en met een ingebouwde Mitz Connector, die als US al geaccepteerd waren, behouden deze status.

Voor de leveranciers van een zorgaanbiedersysteem (XIS) die de 'zorgaanbieder-namens-patiënt' functie willen implementeren, is de PvE ZNP, de IH ZNP en de IH Security Tokens Generiek beschikbaar. In een volgende versie zal de PvE ZNP vervangen worden door een PvE AXI (aansluiting XIS).

De vulling van de Catalogus is gebaseerd op het informatiemodel van een toestemming. De mapping van de gegevenssoorten die uitgewisseld worden naar de OTV-gegevenscategorieën zijn ter illustratie. Deze worden samen met de betreffende uitwisselingssysteemleverancier vastgesteld in het aansluit- en migratietraject.

NB: de ToestemmingsCatalogus kent een eigen release schema en de meest actuele versie wordt gepubliceerd op internet als onderdeel van het Mitz afsprakenstelsel

1.3 Over de documentatie release

De wijzigingen in de documenten worden automatisch bijgehouden in de Word-versie, terwijl in de PDF-versies de wijzigingen doorgevoerd zijn.

2 Wijzigingen in v3.8.1

De volgende zaken zijn verwerkt in de architectuur documentatie v3.8.1

2.1 Implementatie handleidingen:

1. Naast UZI-pas kan het inschrijftoken ook ondertekend worden met het WID van de patiënt (via ZorgID-smart). Het inschrijftoken is nodig om vanuit een XIS (EPD/ECD) samen met de patiënt naar mijnMitz te gaan (via een 'secure link') of na bevestiging door patiënt een toestemming te registreren om te kunnen raadplegen ('toestemmingsknop voor zorgaanbieders om voor een andere bron toestemming te registreren'). De registratie van een toestemming kan direct bij inschrijving aan de balie plaatsvinden. Baliemedewerkers kunnen daarbij een uzi-pas gebruiken (waarmee achter de schermen het token ondertekend wordt met een '2e factor'). In plaats daarvan kan een medewerker ook het WID van de patiënt scannen (rijbewijs/paspoort/ID-kaart), zodat hiervoor geen uzi-pas meer nodig is.
2. Gesloten autorisatievraag:
 - a. De categorie van de raadplegende zorgaanbieder bleek te ontbreken in de specificaties van het (voorbeeld) bericht. Dat is gecorrigeerd.
 - b. Voor leveranciers die nog geen XACML 3.0 ondersteunen, is de gesloten vraag ook beschikbaar in een XACML 2.0 variant. Mitz geeft dan ook een respons terug in XACML 2.
3. Het bericht-id en het 'tracen' van berichten was nog niet voor alle koppelvlakken gestandaardiseerd. In overleg met Aorta architectuur is het (optioneel) mogelijk gemaakt om verschillende ID's mee te geven in de http header van berichten.
4. Aangezien de publieke PKI-certificaten eind 2022 vervallen, worden deze vervangen. De front-end van Mitz zal gebruik gaan maken van private PKI-certificaten, die door actuele versies van webbrowsers automatisch worden vertrouwd (voor de gebruikers zichtbaar via het slotje).
5. In de FHIR-specificaties was sprake van een 'FHIR-baseline URL'. Deze is voor alle koppelvlakken consistent gemaakt. Bij het aansluiten op de test-/productie omgeving wordt de baseline vervangen door de actuele URL. Het wordt aangeraden deze baseline configureerbaar te maken.
6. Validatie van het access token: aangezien uitwisselingsystemen desgewenst ook een deel van de token afhandeling kan uitvoeren (doorsturen van 3 tokens ten behoeve van het accesstoken) wordt bij de validatie van de tokens niet meer gekeken naar het zendende systeem, maar naar de inhoud van de tokens. Daarnaast wordt gecontroleerd of het zendende uitwisselingssysteem op de whitelist van Mitz staat.

3 Wijzigingen in v3.8.1.ad1

De volgende zaken zijn verwerkt in de architectuur documentatie v3.8.1 ad1, ten opzichte van de 3.8.1

3.1 Programma's van Eisen

In verband met de go-live van Mitz is er een finale juridische controle gedaan op de teksten in de frontend. Dat heeft niet geleid tot aanpassingen van de koppelvlakken met een Mitz Connector of met een XIS.

3.2 Toestemmingscatalogus

1. Zie de releasenotes van de toestemmingscatalogus op internet via het Mitz afsprakenstelsel.